AQUA PRO

SYSTÈME DE DÉMINÉRALISATION DE L'EAU.



Manuel d'installation et d'utilisation

CRISPIN
Medical Plus

Merci d'avoir choisi notre système d'eau destiné à la déminéralisation. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre toutes les instructions d'installation..

Manuel d'instructions
AQUA PRO

Crispin Medical Plus ZI La Bergerie, 2 rue Edouard Branly, 49280 La Séguinière, France
Courriel: info@crispin-medical-plus.com
Site Web: https://www.crispin-medical-plus.com

Sous réserve de modifications techniques

Français

Table des matières

Usage prévu 1
Attention / Remarques importantes..... 1
Description et composants 1
Liste de colisage 1
Dimensions 2
Installation 2
Fonctionnement..... 2
Entretien 2


Utilisation Prévue


Le système d'eau est destiné à la désionisation de l'eau potable destinée à être utilisée dans les stérilisateurs à vapeur et n'a pas été évalué pour d'autres utilisations. Ce système doit être installé comme spécifié dans les instructions d'installation.

Attention / Remarques importantes

- Utilisez le système de déionisation de l'eau uniquement sur une alimentation en eau potable FROIDE. La cartouche ne le rendra PAS potable.
- Installer ou stocker dans un endroit où le système de déionisation ne sera pas exposé à des températures inférieures au point de congélation.
- Ne pas installer à la lumière directe du soleil ou à l'extérieur.

Description et composants

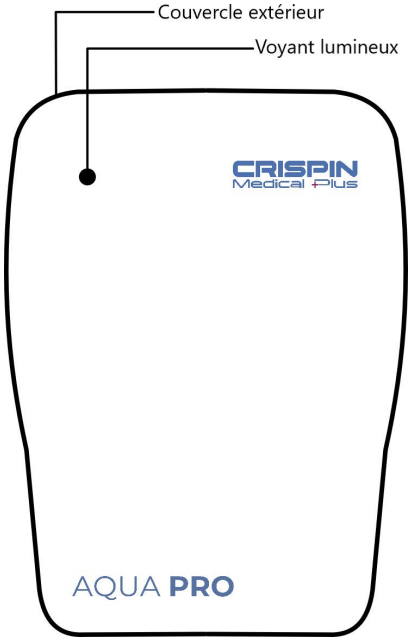

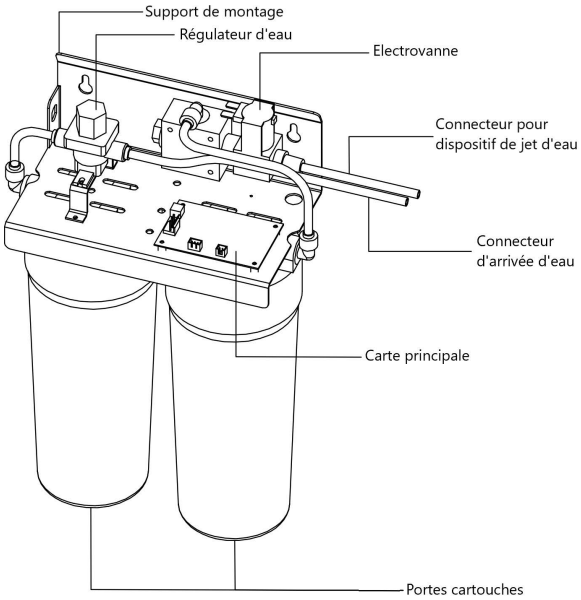


Liste de colisage

Description	Quantité
Système de déionisation de l'eau	1
Clé à cartouche	1
Pistolet d'eau	1
Vis d'expansion 8F	2
Adaptateur d'entrée	1
Tube d'arrivée d'eau	1

Specifications

Technical parameters	
Qualité de l'eau obtenue	<15μS/cm
Volume d'écoulement	1.3L/min
Tension de travail	110V~230V,
Puissance maximale	10W
Température d'utilisation	3~38°C
Pression de l'eau	0.1~0.4MPa
Poids	4.2 kg

Dimensions

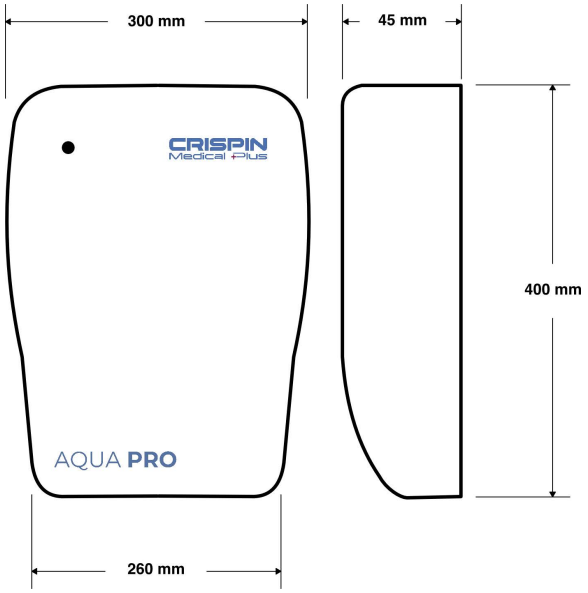

Installation


Choisissez un emplacement pour installer le système. L'emplacement doit être facilement accessible, avec un espace suffisant entre le bas du couvercle des cartouches filtrantes et le sol ou le bas de l'armoire pour permettre le retrait des cartouches filtrantes. Prévoyez suffisamment d'espace de chaque côté du système pour les raccordements des tuyaux.

Montage par vis

Installer les vis dans le mur en laissant un espace de 2 mm entre la tête de la vis et le mur.



Accrochez l'ensemble du système de déionisation de l'eau aux vis.
Serrez ou desserrez les vis comme vous le souhaitez jusqu'à ce que le système soit bien fixé au mur.
Connectez le tube du jet d'eau au port de sortie d'eau. Connectez le câble du voyant lumineux au port du voyant lumineux de la carte mère.

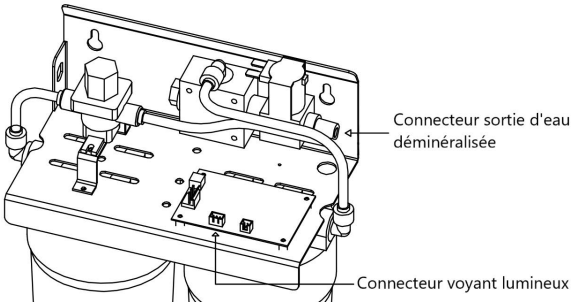

Fonctionnement:

1. Vérifiez que toutes les connexions de tubes.
2. Ouvrez la vanne d'alimentation en eau.
3. Vérifiez l'étanchéité de tous les points de connexion.
4. Connectez le cordon d'alimentation, l'indicateur s'allumera en vert, cela signifie que l'eau sortira normalement.


Note:
Revérifiez tous les raccordements d'eau quelques heures plus tard pour vérifier s'il y a pas de petites fuites.

Maintenance

Lorsque le voyant s'allume en rouge, il est temps de remplacer les cartouches. Cela se produira après une utilisation prolongée et variera en fonction de la qualité et de la dureté de l'eau locale.

Remplacement cartouche

Coupez l'alimentation électrique.
Coupez l'alimentation en eau du système.
Allumez le jet d'eau pour évacuer l'eau résiduelle dans le système.

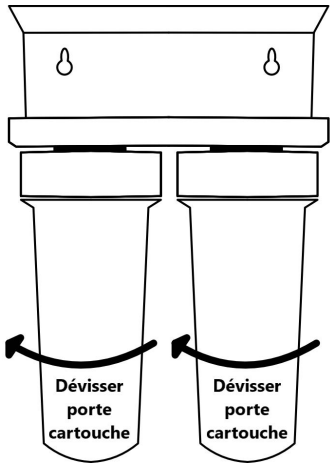

1. Retirez le couvercle des cartouches à l'aide de la clé (fournie).
2. Retirez l'ensemble des cartouches.
3. Remplacez les cartouches par des cartouches neuves et tournez le couvercle de la cartouche vers la droite pour le fixer à la tête.