
CRISPIN Medical +Plus

MANUEL D'UTILISATION

SEAL PRO

Thermosoudeuse

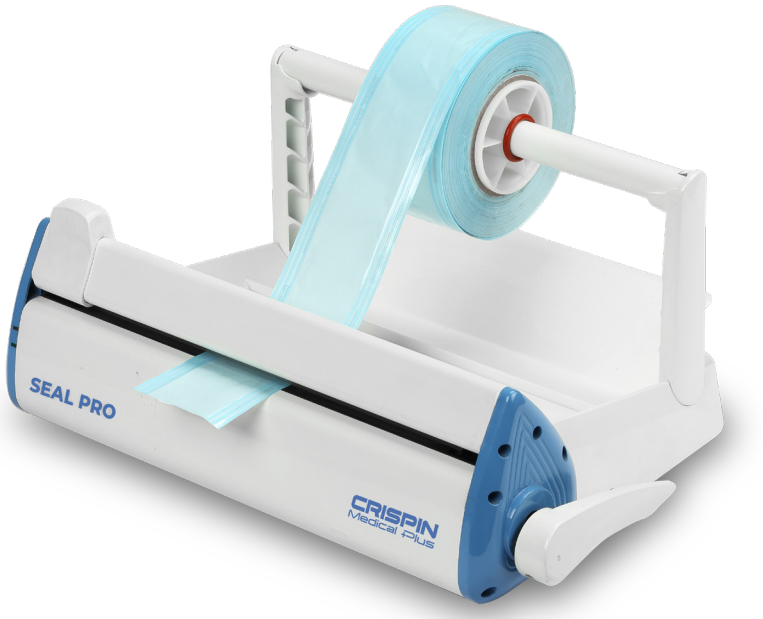

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.
Veuillez conserver ce manuel d'instructions

MANUEL D’UTILISATION

SEAL PRO

THERMOSOUDEUSE

Crispin Medical Plus
Adresse : ZI La Bergerie, 2 rue Edouard Branly, 49280 La Séguinière, France
Téléphone : +33 2 41 58 81 45

© Toutes les images sont soumises aux produits réels. Nous nous réservons le droit d’ interprétation finale.

Bienvenue chez Crispin Medical Plus, nous vous remercions de votre achat.

Crispin Medical Plus est un fabricant professionnel d'équipements médicaux, dont le siège est à Cholet, en France. La mission de Crispin Medical Plus est de produire des équipements médicaux qui répondent aux normes les plus élevées de performance et de fiabilité. Un contrôle strict de la qualité est appliqué pendant la fabrication de nos équipements médicaux. Nous espérons que vous apprécierez votre expérience en matière de performance de cet appareil. Si vous avez des questions, des commentaires ou des demandes spéciales, veuillez contacter Crispin Medical Plus directement, nos agents ou représentants agréés.

L'équipe Crispin Medical Plus vous souhaite leurs meilleures salutations et un bon usage de votre appareil !

CRISPIN MEDICAL PLUS
ZI La Bergerie, 2 rue Edouard Branly, 49280 La Séguinière, France
Téléphone : +33 02 41 58 81 45
Courriel: info@crispin-medical-plus.com
Site Web: https://www.crispin-medical-plus.com

TABLES DES MATIÈRES

1. Informations de sécurité..... 7

2. Introduction..... 8

3. Spécifications 8

4. Instructions d'opérations..... 8

5. Maintenance..... 9

6. Contenu du paquet..... 10

7. Garantie du produit..... 10

8. Installation (version optionnelle)..... 11

9. Tableau d'état des voyants de la thermosoudeuse..... 12

1. Informations de sécurité


- Puissance d'entrée : **230 V (50/60 Hz)**.
  Vérifiez l'électricité locale avant de brancher l'alimentation.

- Gardez un espace suffisant pour installer la thermosoudeuse.

- N'insérez pas le rouleau de stérilisation sans action.

- Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sec et sûr.

- Déconnectez la fiche d'alimentation avant de vous absenter pendant un long moment.
  Après le scellement, veuillez retirer le rouleau de scellement.
  Le scellement se fait entre les deux supports, largeur maximale de scellement : **280 mm**.



Barre de compression

Définitions

La signification des différents symboles est définie sur l'étiquette de cette thermosoudeuse.

!	Faire attention
	Consulter les documents d'accompagnement
	Type BF
SN	N° de série du produit
CE	Approuvé par la CE

2. Introduction

La thermosoudeuse SEAL PRO est conçue pour les cliniques dentaires et médicales. Les instruments doivent être stockés dans des boîtes antibactériennes ou emballés dans des rouleaux de stérilisation.
La thermosoudeuse est nécessaire et utile pour emballer les instruments à une température précise. La SEAL PRO a de merveilleuses performances en matière d'interface de collage.
Vous pouvez trouver le numéro de modèle et le numéro de série au dos de l'appareil. Envoyez-nous par e-mail les informations avec les coordonnées du revendeur. Cela nous aidera à créer une connexion entre le fabricant, le revendeur et l'utilisateur. Merci d'avance !

3. Spécifications

- Puissance d'entrée : 230V~ 240V, 50/60Hz
- Puissance nominale : 100 W
- Température de scellement : 200°c + 10°c
- Largeur de scellement : 12 mm
- Poids net : 4.8 kg
- Poids brut : 7 kg
- Taille de l'emballage : 50 x 42 x 21 cm

4. Instructions d'opérations

- Branchez le cordon d'alimentation, allumez l'interrupteur d'alimentation.

- La lumière verte clignotera après avoir allumé l'interrupteur d'alimentation. Cela prendra environ 3 minutes pour le préchauffage.

- La thermosoudeuse sera prête à sceller après que la lumière verte s'arrête de clignoter. (la lumière verte doit rester fixe)

- Insérez le rouleau de stérilisation, assurez-vous que vous l'insérez d'une manière correcte.(Ci-dessous vous trouverez la démonstration correcte).


- Appuyez sur la poignée en avant ou en arrière pendant 3 secondes, la machine vous alertera par un «BIP» (une alerte lumineuse) , la lumière jaune restera allumée, ce qui signifie que les instruments sont bien scellés. Si vous ne relâchez pas la poignée pendant 6 secondes, la machine vous alertera par un «BiP» constant.


5. Maintenance

- Nettoyage : éteindre la machine, frotter la machine avec des chiffons doux.
- Remplacement de la lame

1. Dévissez la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé Allen (pièces n°1)
2. Dévissez les 6 autres vis à l'aide d'un tournevis à croix (pièces n°2, n°3 et reposées).
3. Retirez le plastique latéral (pièce n°4)
4. Retirer le groupe de lames (pièce n°5)
5. Dévissez la vis n° 6 avec un petit tournevis à croix.
6. Retirez la plaque de lame n° 7
7. Remplacer la lame n° 8
8. Remontez toutes les pièces.

Remarque : assurez-vous que la thermosoudeuse est froide lorsque vous remplacez la lame. Faites attention à la lame tranchante.

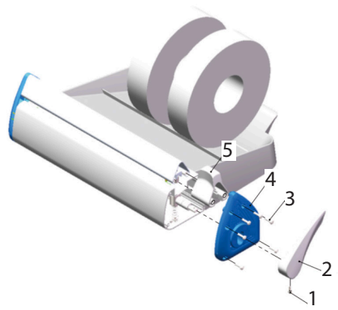




6. Contenu du paquet

NO	Produits	QTÉ	Remarques	vérifier et accepter
1	SEAL PRO	1		■
2	Cordon d'alimentation coudé	1	Bouchon requis par le client	■
3	Sachet de stérilisation	1		■
4	Instructions d'opérations	1		■
5	Carte de test d'étanchéité (haute température)	5		■
6	Bec verseur arrière (bouchon)	2		■
7	Tuyau en aluminium	1	Optionnel	■
8	Colonne	2	Optionnel	■
9	Anneau en caoutchouc	4	Optionnel	■
10	Vis combinée M4 x 8	2	Optionnel	■

7. Garantie

La thermosoudeuse est garantie pendant un an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'abus ou la mauvaise utilisation.

8. Installation (version optionnelle)

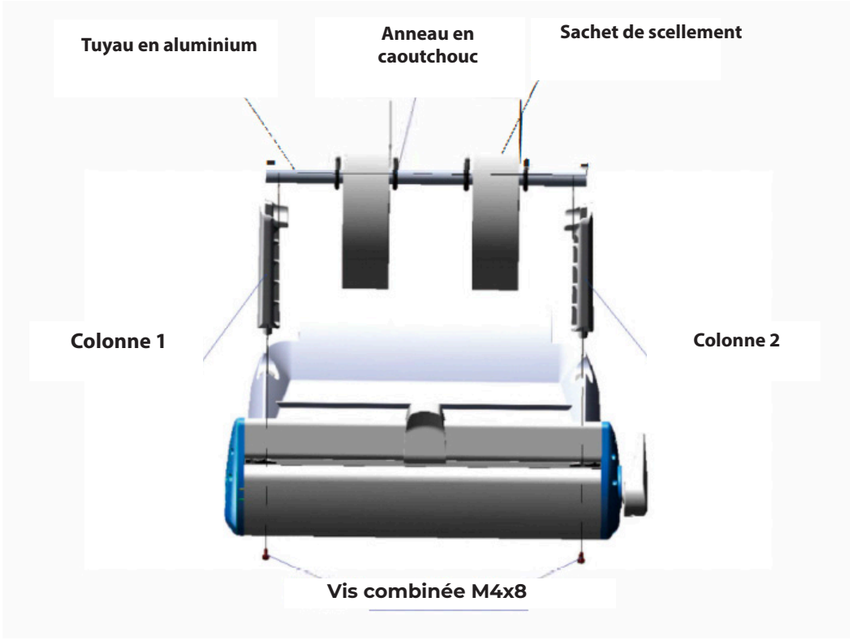

Étape 1 : Sortez deux colonnes de la boîte à accessoires (mur intérieur avec n° 1/2),

Installez la colonne 2 sur la droite comme le montre la photo. Et installez la colonne 1 sur la gauche. Utilisez ensuite les deux vis de la boîte d'accessoires pour les serrer par le bas.

Étape 2 : Retirez le tuyau d'aluminium, l'anneau en caoutchouc et le papier d'étanchéité, puis placez le tuyau d'aluminium avec le papier de scellement sur la colonne à l'envers.

9. Tableau d'état des indicateurs de la thermosoudeuse

N°	**indicateur du témoin**	**Buzzer (bruit)**	**Statut**	**Solution**
1	- Lumière verte éteinte - Lumière jaune éteinte	/	Coupure du tuyau de chauffage	Vérifiez si le tuyau de chauffage et le fil de connexion sont coupés.
2	- Lumière verte clignote - Lumière jaune éteinte	/	Sous la chaleur	Attendre la fin du chauffage
3	- Lumière verte clignote - Lumière jaune allumée	Explosion («boum»)	Sous la chaleur, la poignée de fermeture est pressée vers le bas	Desserrer la poignée de scellement
4	- Lumière verte allumée - Lumière jaune éteinte	/	Température constante, prête à sceller	Prête à sceller
5	- Lumière verte allumée - Lumière jaune clignote	Bip	temps de scellement supérieur à 3 secondes	Suggère de desserrer la poignée de scellement
6	- Lumière verte allumée - Lumière jaune allumée	Explosion («boum»)	Temps de scellement supérieur à 6 secondes	Desserrer la poignée de scellement
7	-Lumière verte clignote toutes les 3 secondes - Lumière jaune éteinte	/	En attente	Redémarrer ou presser la poignée de scellement

Crispin Medical Plus
Adresse : ZI La Bergerie, 2 rue Edouard Branly, 49280 La Séguinière, France
Téléphone : +33 2 41 58 81 45

© Toutes les images sont soumises aux produits réels. Nous nous réservons le droit d' interprétation finale.